

兰州大学草地农业科技学院实验室安全

工作简报

2024 年第 4 期（总第 24 期）

草地农业科技学院实验室安全工作小组 2024 年 5 月 17 日

2024 年 5 月 17 日，为切实做好实验室安全工作，学院实验室安全工作小组成员翁秀秀、杨倩、古丽君、马宝宏对碧野楼、逸夫生物楼四楼、岫云楼三楼、校医院四楼的各实验室安全进行了检查。

本次安全检查主要针对的重点内容是：1. 消防通道是否畅通；2. 易制毒、易制爆药品的存放管理；3. 废液的存储管理；4. 实验室仪器用电安全；5. 高压灭菌锅使用与管理；6. 实验室气瓶管理；7. 通风橱底下柜子是否存放易燃易爆试剂、药品；8. 实验操作过程是否规范。对于优秀的实验室提出表扬，对于存在问题的实验室要求限期整改。



一、本月优秀实验室



二、主要存在隐患和共性问题

1. 个别实验室无人值守，部分学生在实验室做试验不穿实验服。
2. 易制毒、易制爆药品柜未执行双人双锁，与其他药品混放。
3. 插线板未固定，放置地面。
4. 废液桶没有张贴标识，无托盘。
5. 烘箱上堆放物品。
6. 个别气瓶没有固定。
7. 部分消防通道被占用。

三、现场照片

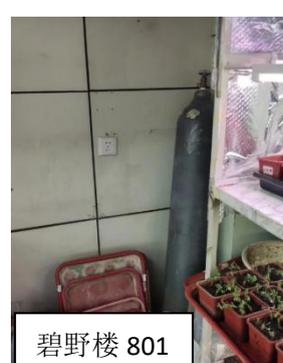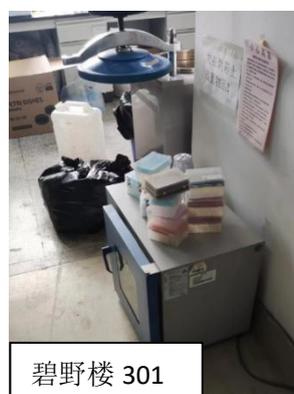

四、问题清单

实验室房号	责任人	研究所/中心	问题	建议整改措施	限期整改完成时间	
碧野楼 F102	刘权	大型仪器中心	有一个气瓶未固定	气瓶用气瓶架或者铁链固定好	5月24日	
步云楼 110	王强	草地生态研究所	气瓶未固定	气瓶用气瓶架或者铁链固定好	5月24日	
			插线板未固定, 平放	插线板应立放, 并固定于墙面	5月24日	
碧野楼 301	方龙发	草类植物育种与种子研究所	烘箱上放置物品	烘箱要保持良好的通风散热, 上面不得放置物品	立即	
			插线板未固定, 平放于地面	插线板应立放, 固定于墙面	5月24日	
碧野楼 801	张吉宇		气瓶未固定	气瓶用气瓶架或者铁链固定好	5月24日	
碧野楼 802	韩云华		有一个废液桶未贴标签, 无托盘	按照规定废液桶贴上“无机”“有机”标识, 底下放置托盘	5月24日	
碧野楼 406	常生华		草畜生产系统调控研究所	烘箱上放置物品	烘箱要保持良好的通风散热, 上面不得放置物品	立即
碧野楼 602	郭正刚		草地保护研究所	插线板未固定, 平放于地面	插线板应立放, 固定于墙面	5月24日
校医院 4楼	古丽君	废液桶未放置托盘		废液桶底下放置托盘	5月24日	
校医院 阁楼	段廷玉	消防通道堵塞		清理物品, 确保消防通道畅通	5月24日	
岫云楼 308	古丽君	氯仿、硝酸钾等易制爆、易制毒化学品未按规定存放, 无双锁, 与普通药品混放		易制爆、易制毒化学品应单独存放, 双锁双人管理	5月24日	