

兰州大学草地农业科技学院实验室安全


工作简报

2025年第2期（总第31期）

草地农业科技学院实验室安全工作小组 2025年2月20日

新学期伊始，为落实学校关于新学期实验室安全工作的要求，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，切实防范化解实验室安全风险，守护实验室安全防线，学院安全工作小组成员杨倩、常生华、陆妮、冯彦丽、缪秀梅按照高校实验室分级管理要求及《高等学校实验室安全检查项目表（2024）》的相关内容，于2月20日对碧野楼、逸夫生物楼四楼、岫云楼三楼、校医院四楼的各实验室安全进行了检查，切实排除实验室安全隐患。本次安全检查主要针对的重点内容是：**1.实验室环境卫生；2.实验室水、电、气路安全；3.危化品和废弃物储存情况；4.消防设备是否齐全、消防通道是否畅通；5.实验人员安全防护等。**对于优秀的实验室提出表扬，对于存在问题的实验室要求限期整改。







一、本月优秀实验室

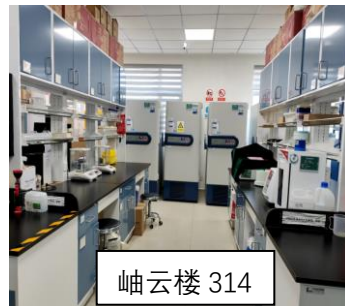

二、主要存在隐患和问题

1. 不使用的仪器未及时断电；
2. 部分学生做实验不穿实验服；
3. 气瓶标识不全，未有效固定；
4. 管制类化学品未及时上锁。

三、现场照片

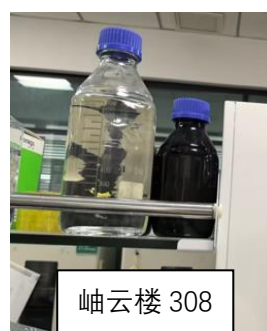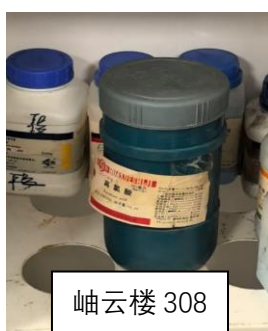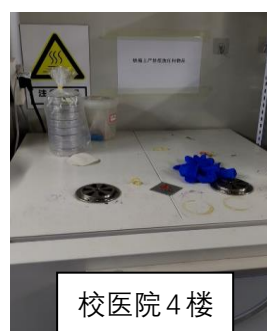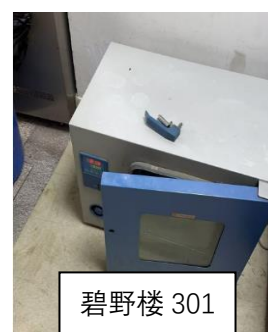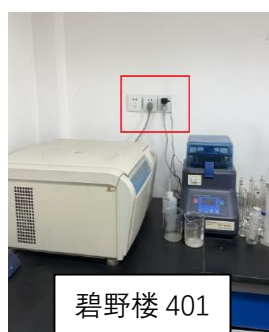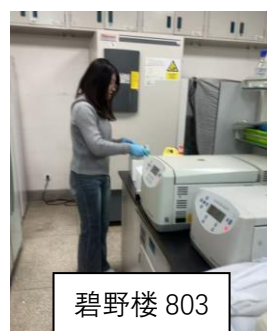

四、实验室问题清单

实验室房号	责任人	研究所	问题	建议整改措施	限期整改完成时间
碧野楼 801	张吉宇	草类植物育种与种子研究所	气瓶上缺少标识	气瓶应在检验合格期内，标识完备并安全固定，远离热源	2月27日
碧野楼 802	张吉宇		不使用的仪器未及时断电	不使用的仪器要及时切断电源	即刻
碧野楼 803	张吉宇		学生做实验未穿实验服	实验人员在实验过程中需做好自身防护	立即
碧野楼 301	方龙发		插排在地面放置	插线板应远离地面并进行有效固定	即刻
碧野楼 301	方龙发		烘箱把手损坏仍在用，烘箱门在试用期间无法彻底关闭	烘箱使用期间需保证配件完整且无安全隐患	2月27日
碧野楼 601	杨倩	农区草业研究所	不使用的仪器未及时断电	不使用的仪器要及时切断电源	即刻
碧野楼 501	吴淑娟	草业系统元素利用与管理研究所	不使用的仪器未及时断电	不使用的仪器要及时切断电源	即刻
碧野楼 401	常生华	草畜生产系统调控研究所	不使用的仪器未及时断电	不使用的仪器要及时切断电源	即刻
碧野楼 F205	冯彦丽	草地生态研究所	气瓶上缺少标识	气瓶应在检验合格期内，标识完备并安全固定，远离热源	2月27日
步云楼 110	朱剑霄		气瓶上缺少标识且未有效固定	气瓶应在检验合格期内，标识完备并安全固定，远离热源	2月27日
校医院 4 楼实验室	古丽君	草地保护研究所	烘箱上面放置物品	烘箱上严禁摆放任何物品	即刻
			学生做实验未穿实验服	实验人员实验过程中需做好自身防护	立即
岫云楼 308	古丽君		易制爆试剂未执行双人双锁	易制爆试剂应严格执行双人双锁	2月27日
			配制的试剂未进行有效标识	配制试剂应有完整的标识，标明试剂名称、配制人员及日期	即刻